



**H. HARTZIEKENHUIS
MOL**

**Inhaleren met een
voorzetkamer**

WELKOM


**BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL**

Inhaleren met een voorzetskamer

1. Haal de beschermdop van de puffer (doseeraerosol).
2. Puffer krachtig schudden en in de voorzetskamer plaatsen.




3. Baby's en peuters plaatsen het masker van de voorzetskamer over neus en mond. Zorg dat dit goed aansluit.
Grotere kinderen plaatsen het mondstuk van de voorzetskamer tussen de tanden en sluiten de lippen om het mondstuk.

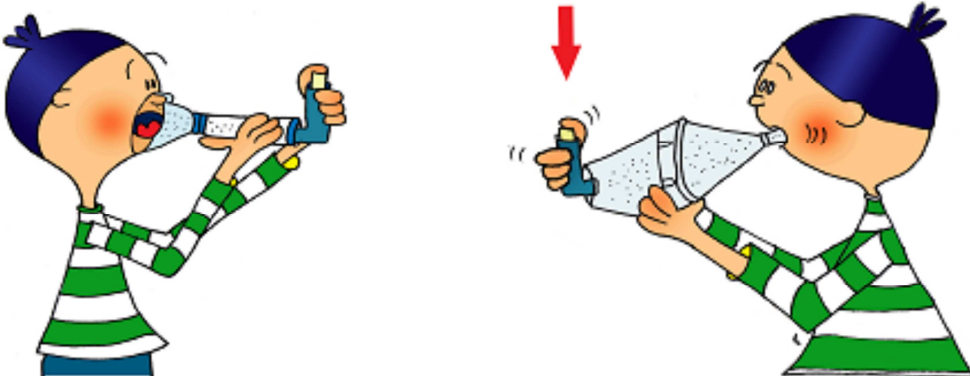

4. Druk de puffer 1x in.
5. Laat uw kind 8x rustig in- en uitademen door de voorzetskamer.
6. Herhaal handeling 4 en 5 wanneer u meerdere puffjes moet toedienen.
7. Laat uw kind de mond spoelen met water na het puffen met corticosteroiden. Lukt dit niet, laat uw kind dan iets eten of drinken.

Controle inhoud puffer

Haal de puffer uit het plastic hulsje en leg deze in een bakje met water. Hieronder kunt u zien hoeveel er nog in zit.

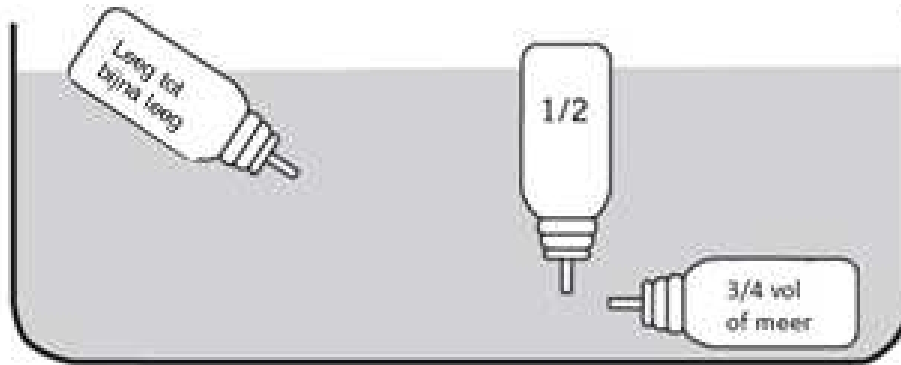

Schoonmaken

Een voorzetkamer die u dagelijks gebruikt, moet u 1x per week schoonmaken.

Verwijder eerst de puffer. Haal de voorzetkamer uit elkaar. Was de losse onderdelen in schoon, lauw water met afwasmiddel.

De voorzetkamer zonder afspoelen op een schone theedoek aan de lucht laten drogen. Niet droogwrijven! De voorzetkamer niet afspoelen, niet föhnen, niet op de verwarming drogen en niet in de vaatwasser steken!

Let op!

Bewaar de puffer op een droge plek op kamertemperatuur.

Na verloop van tijd kunnen de klepranden van de voorzetkamer gaan verharderen en omkrullen. Dan moet u de voorzetkamer in zijn geheel vervangen.

Iedere voorzetkamer moet na 1 jaar intensief gebruik vervangen worden.

Kindergeneeskunde H. Hartziekenhuis Mol

Afspraken consultatie: 014/71 23 73

Dr. D. Dekkers
Dr. P. Givron
Dr. A. Janssen
Dr. M. Naert
Dr. L. Peeters



Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.
Elke verspreiding of reproductie zonder toestemming van de eigenaar is verboden.
Datum laatste aanpassing: 31 mei 2018
Naam auteur / verantwoordelijke: Dr. D. Dekkers
Kwalificaties auteur / verantwoordelijke: Kinderarts